# ESPECIFICACIÓN PREFORMA DE 84 GRAMOS

| Medición | Especificaciones | Unidad | Equipo de Control |
|---|---|---|---|
| Peso | 84,00 ± 0,9 | g | Balanza de Precisión |
| Largo | 151,50 ± 0,8 | mm | Calibre Digital |
| Fondo | 3,000 | mm | Medidor de Espesores |
| Cuello | 1,90 | | |
| Cuerpo | 3,610 | | |
| Cota X | 19,500 ± 0,4 | mm | Pasa - No Pasa Calibre Digital |
| Cota Z | 51,600 ± 0,250 | | |
| Cota D | 13,100 ± 0,150 | | |
| Cota A | 48,200 ± 0,150 | | |
| Cota T | 47,250 ± 0,150 | | |
| Cota E | 44,800 ± 0,150 | | |
| Cota F | 41,150 ± 0,150 | | |
| Cota D1 | 43,340 | | |
| Cota D2 | 44,430 | | |
| Acetaldehído (AA) | máx. 6 | ppm | Cromatógrafo |
| Color | según CONTEPLAT S.A. | n/a | Espectrofotómetro |

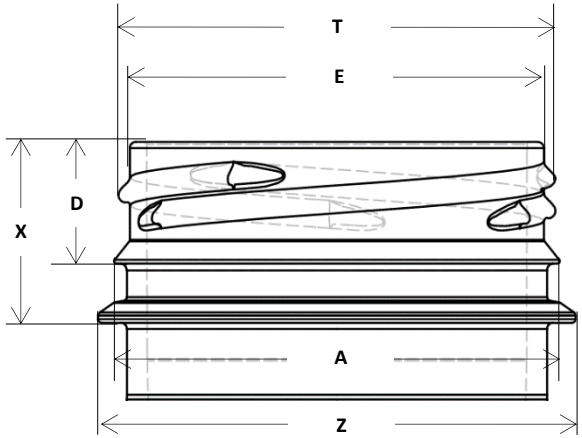


Diámetro Interno del Finish




**Rosca Baja 48/41**

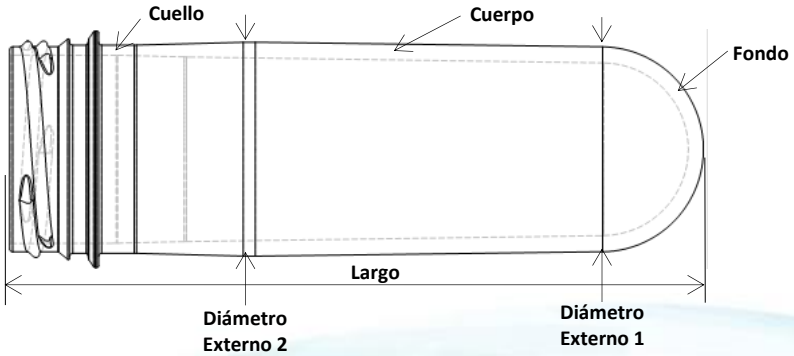


CONTEPLAT